Q/GDW

1		1
2		1
3		1
4		1
5		3
6		4
7		7
8		8
9		8
	A	9
	B	11
	C	13
	D	19
	E	28
		32

“ ”

,, l ,, D

2^{i} đ

ž - ¯" ypÐQP

A.1

A.2

A.3

A.4

A

B.1

B.2

C.1

					m^2
1				(0~20000)N, ≥5kHz, 2.5 $5_0^{+0.01}$kg 48mm 45#	≥15
				45# , $3_0^{+0.05}$kg, : 60°, 0.5mm, 40mm, 28mm, HRC45	
2				20kN, ≥800mm 1.0	≥15
3				20kN, ≥800mm 1.0	
4				20kN, ≥800mm 1.0	
5				\	\

							㎡
6				20kN	≥ 800㎜	1.0	≥ 15
7				20kN	≥ 800㎜	1.0	
8				≥ 50㎜Ω	1	≥ 30A	≥ 15

C.2

㎡

						㎡
			DL/T 740			
3	330kV	1	500kV	1	≥ 300	20m
			1500kV	1		
			DL/T 971			
4		1	50kV	1		
			100kV	1		
5	35kV	1	≥ 50mΩ	1	≥ 30A	
			r			
			100kV	1		
6	66kV~220kV		≥ 50mΩ	1	≥ 30A	

					m^2
8	( ) 35kV		[1]		
				150kV 1	
9	( ) 66kV~220kV		[1]		
				500kV 1	
10	( ) 330kV		[1]		
				1500kV 1	
				1000kV 1	
[2]11				0.5m	≥50
				150kV 1	
12				50kV 1	≥30
				DL/T 1476	
13				100kV 1	

C.3

					㎡
1				50kV 1	≥30
			1		
				50kV 1	
				30mA 1	
2				50kV 1	
			1		
				50kV 1	
				30mA 1	
			1		
3				50kV 1	≥30
				DL/T1476	

C.4

					m^2
1				5kN， 1 ，AC220V	≥15
2				5kN， 1 ，AC220V	
3				5kN， 1 ，AC220V	
4				300kN/20kN 15m， 1.2m 1.0	
5				5kN， 1 ，AC220V	
				(5Kg/10kg，3%， 300kg)	
6				5kN， 1 ，AC220V	
				(5Kg/10kg，3%， 300kg)	
				1T	

D.1 D.2- D.7 D.1

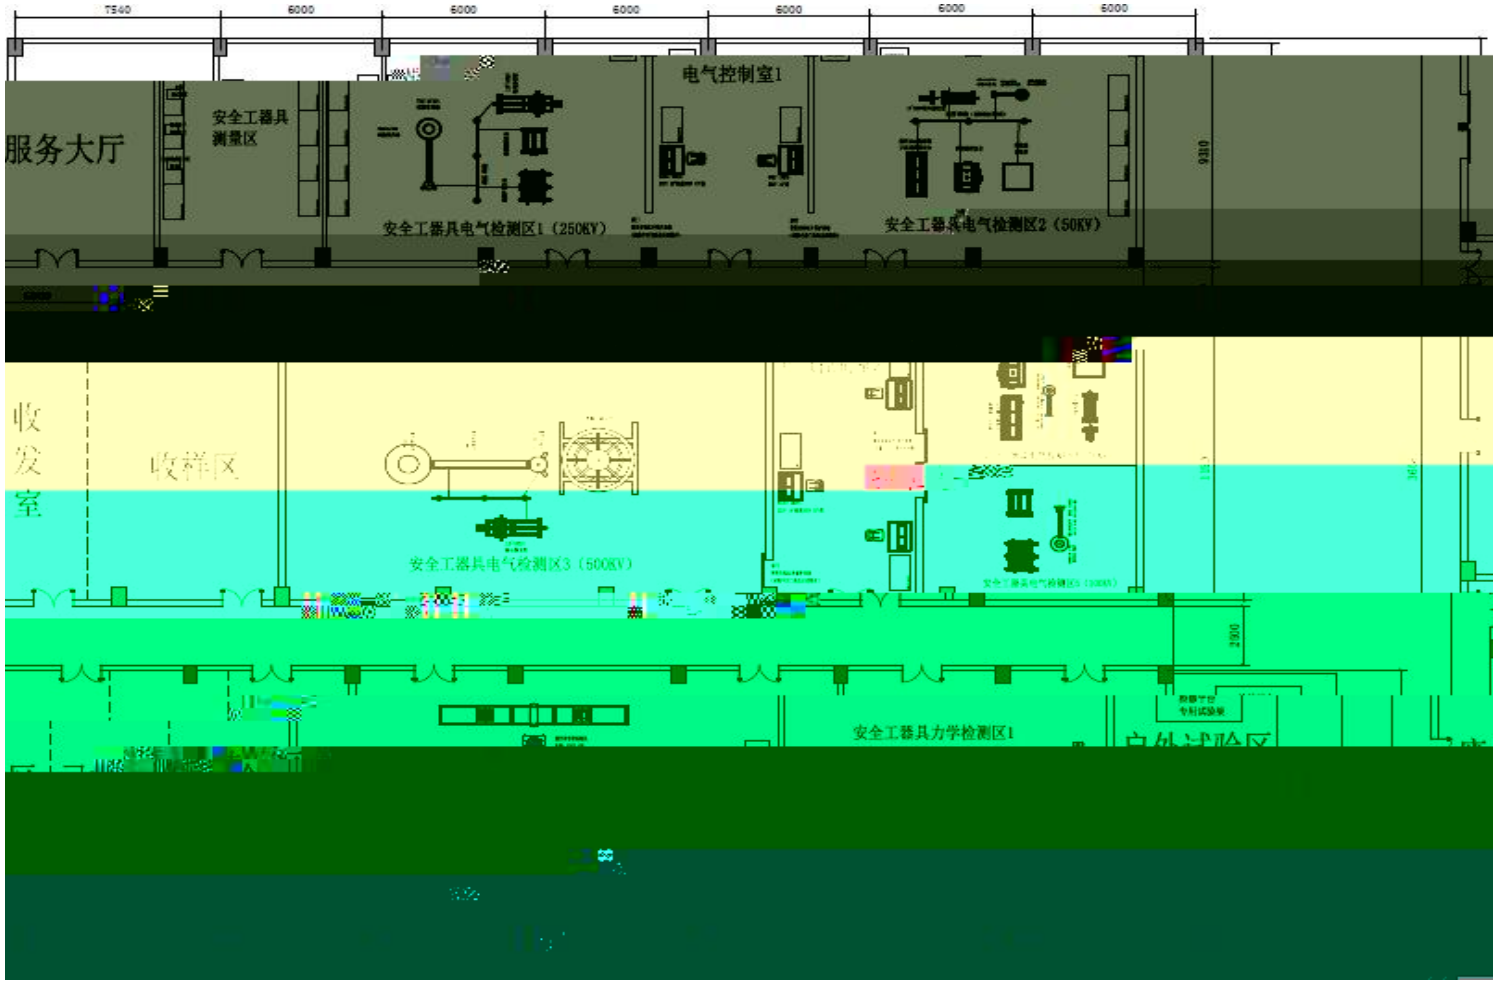
7540
6000
6000
6000
6000
6000
6000
服务大厅
安全工器具
测量区
电气控制室1
安全工器具电气检测区1（250KV）
安全工器具电气检测区2（50KV）
9310
收
发
室
收样区
安全工器具电气检测区3（500KV）
2300
安全工器具力学检测区1

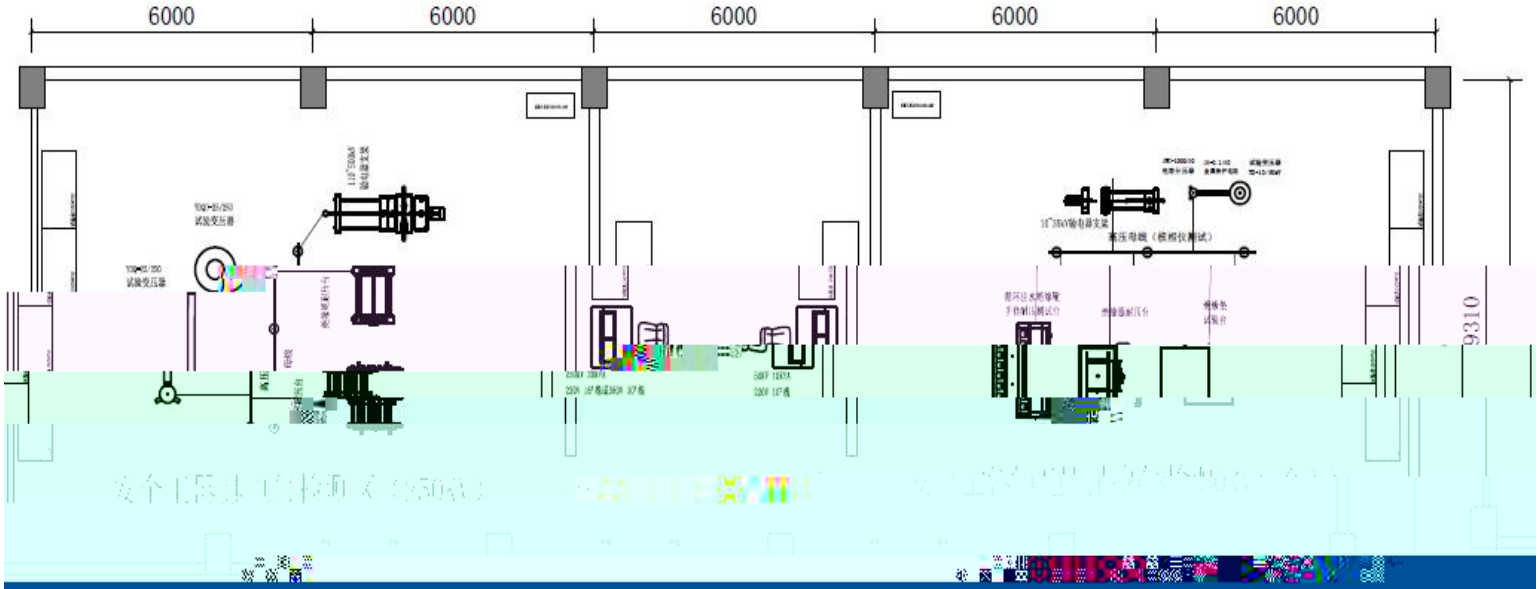

如果电压等级做到110及以下则最好需要2个耐压室

250kV主要检测绝缘杆、验电器、绝缘绳等试验电压高于50kV的耐压试验（需要高度5米以上）

50kV主要检测手套靴子、绝缘服、绝缘垫、验电器等试验电压低于50kV的耐压试验

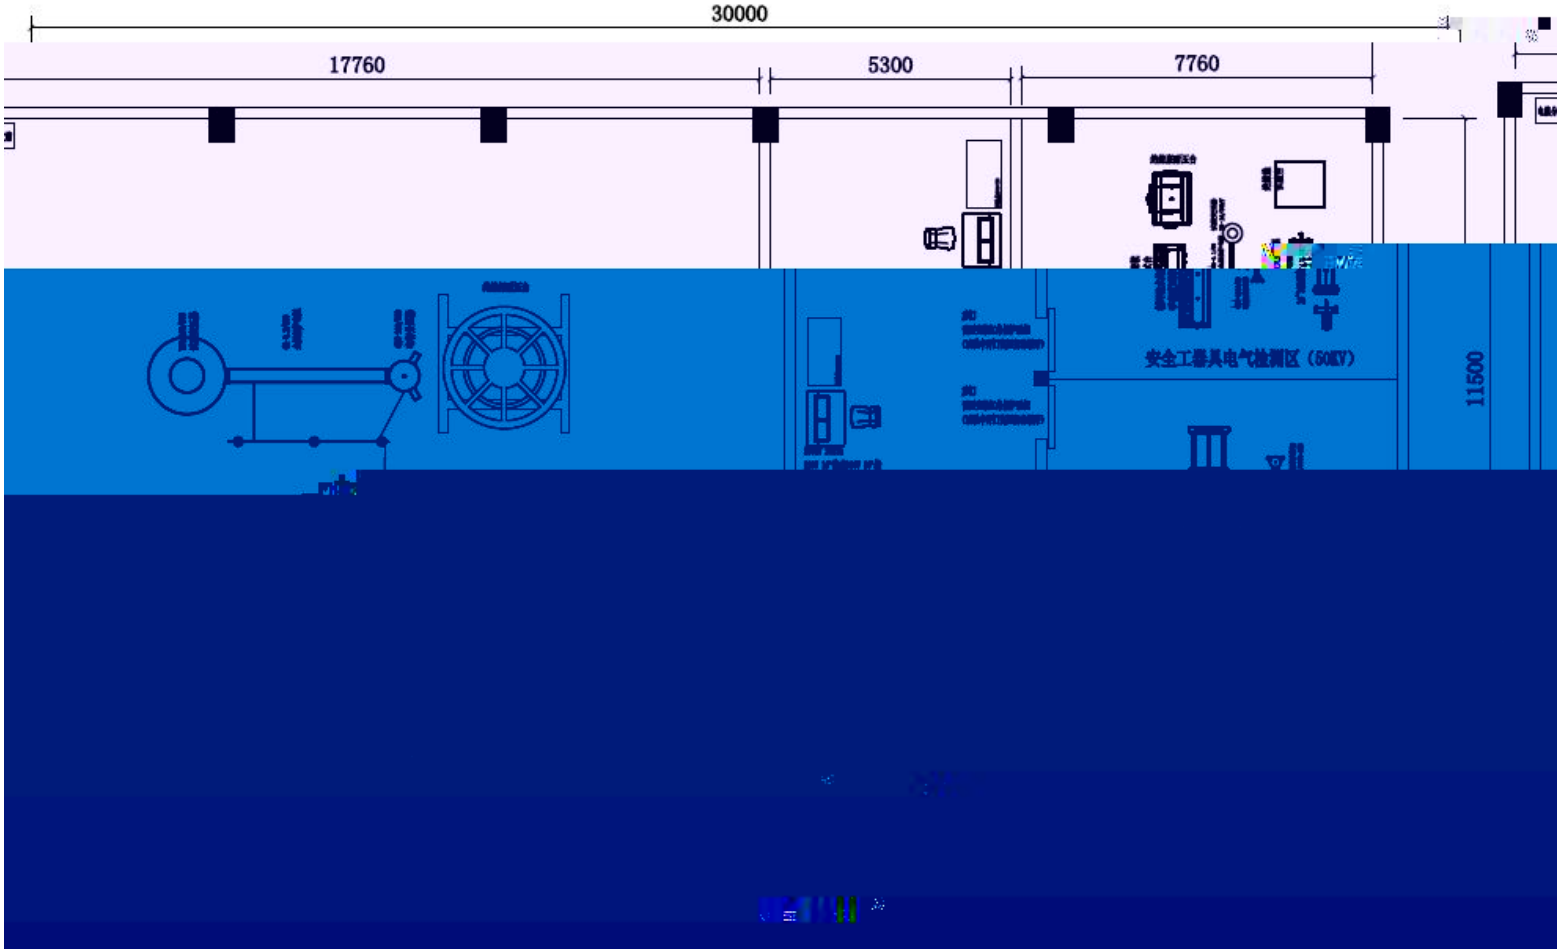
30000
17760
5300
7760
安全工器具电气检测区（60KV）
11500

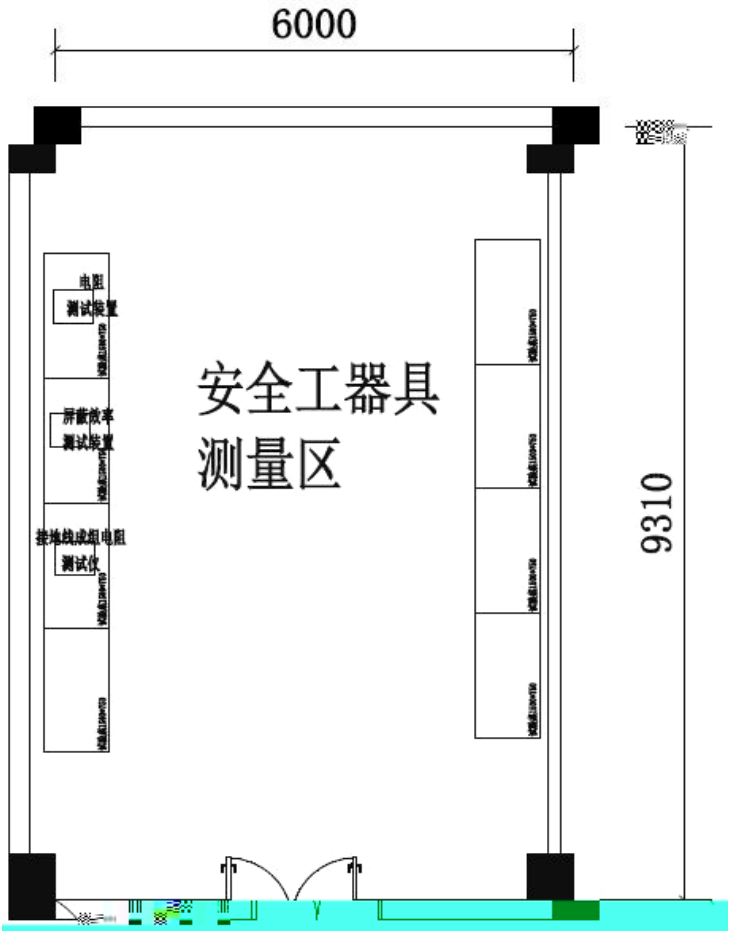
6000
9310
安全工器具
测量区
电阻
测试装置
屏蔽效率
测试装置
接地线成组电阻
测试仪

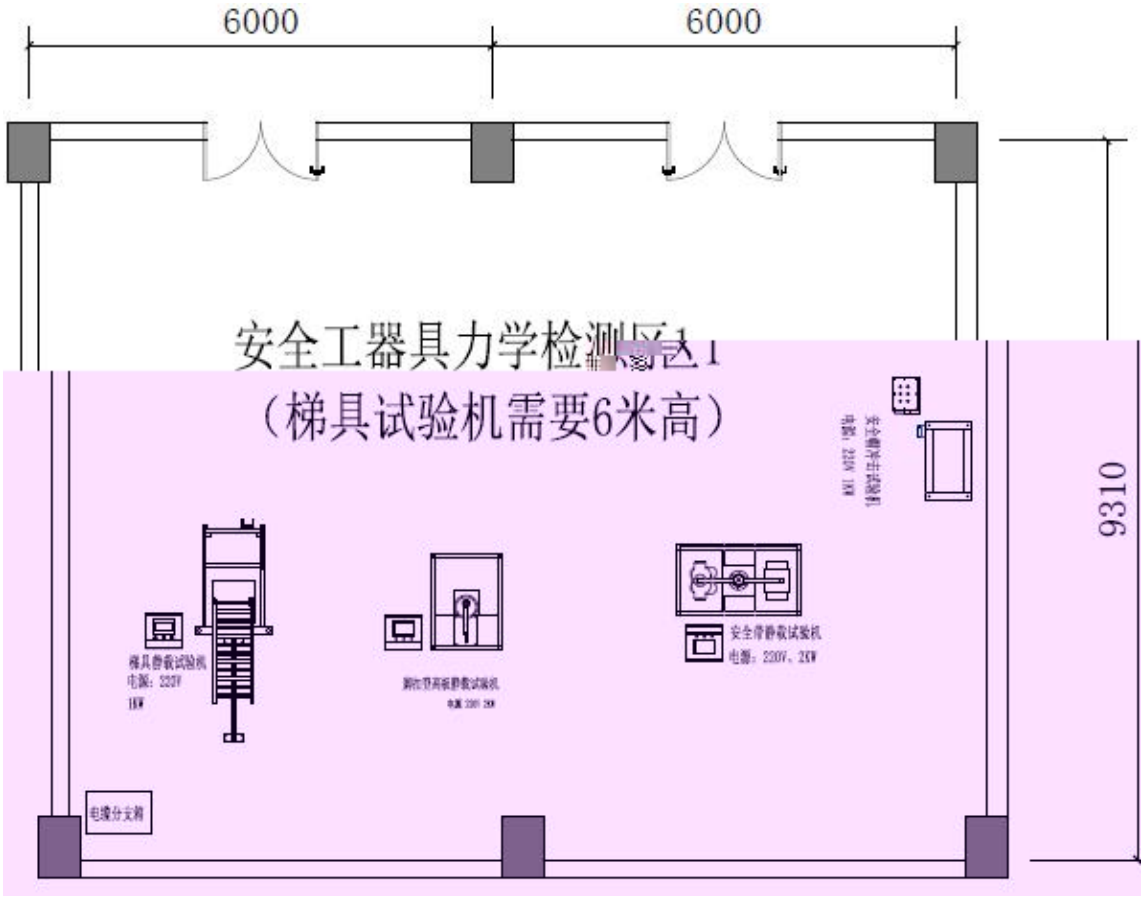
6000
6000
安全工器具力学检测区1
（梯具试验机需要6米高）
9310
梯具静载试验机
电源：220V
1KW
安全带静载试验机
电源：220V、2KW
电缆分支箱

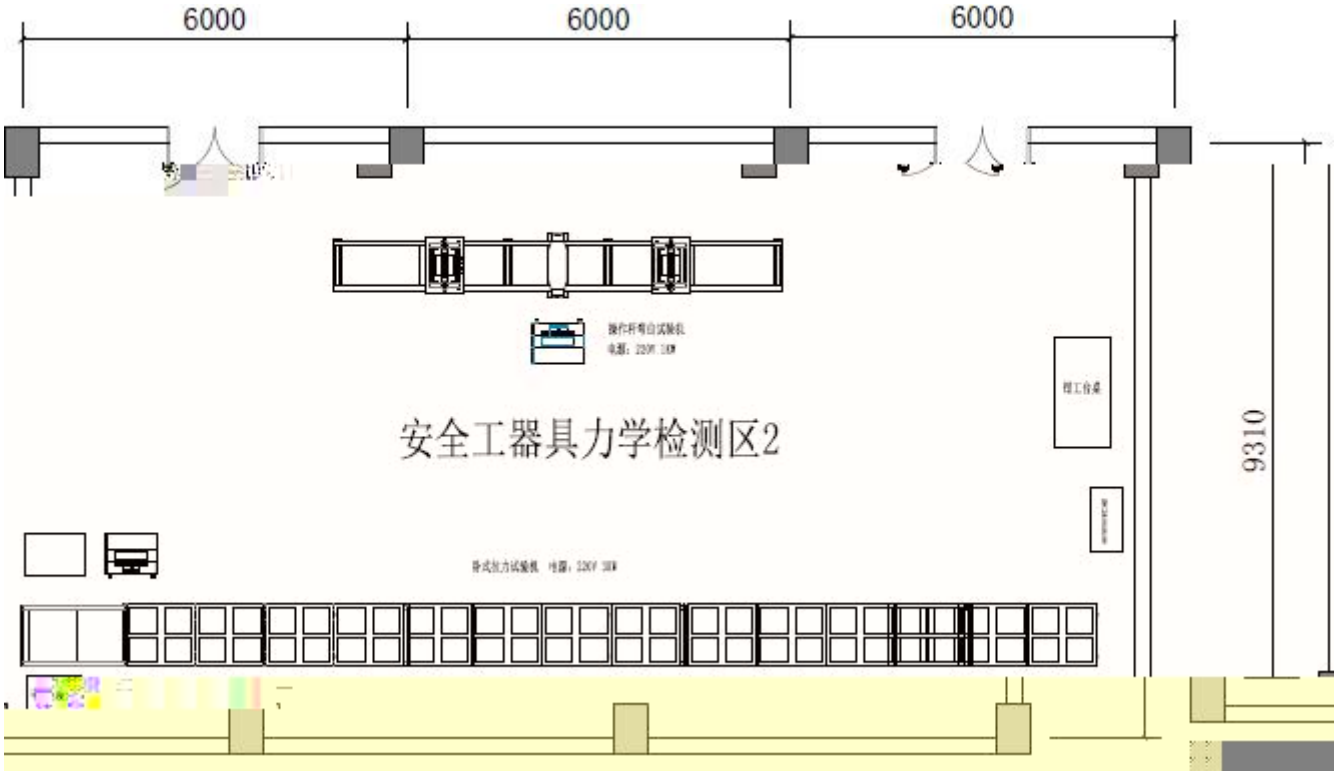
6000
6000
6000
安全工器具力学检测区2
9310

户外试验区
地面硬化平整，
场地配1T起重装置
9000
检修平台用
锥形模拟杆
6000

检测机构名称

合格证

E.2-E.4

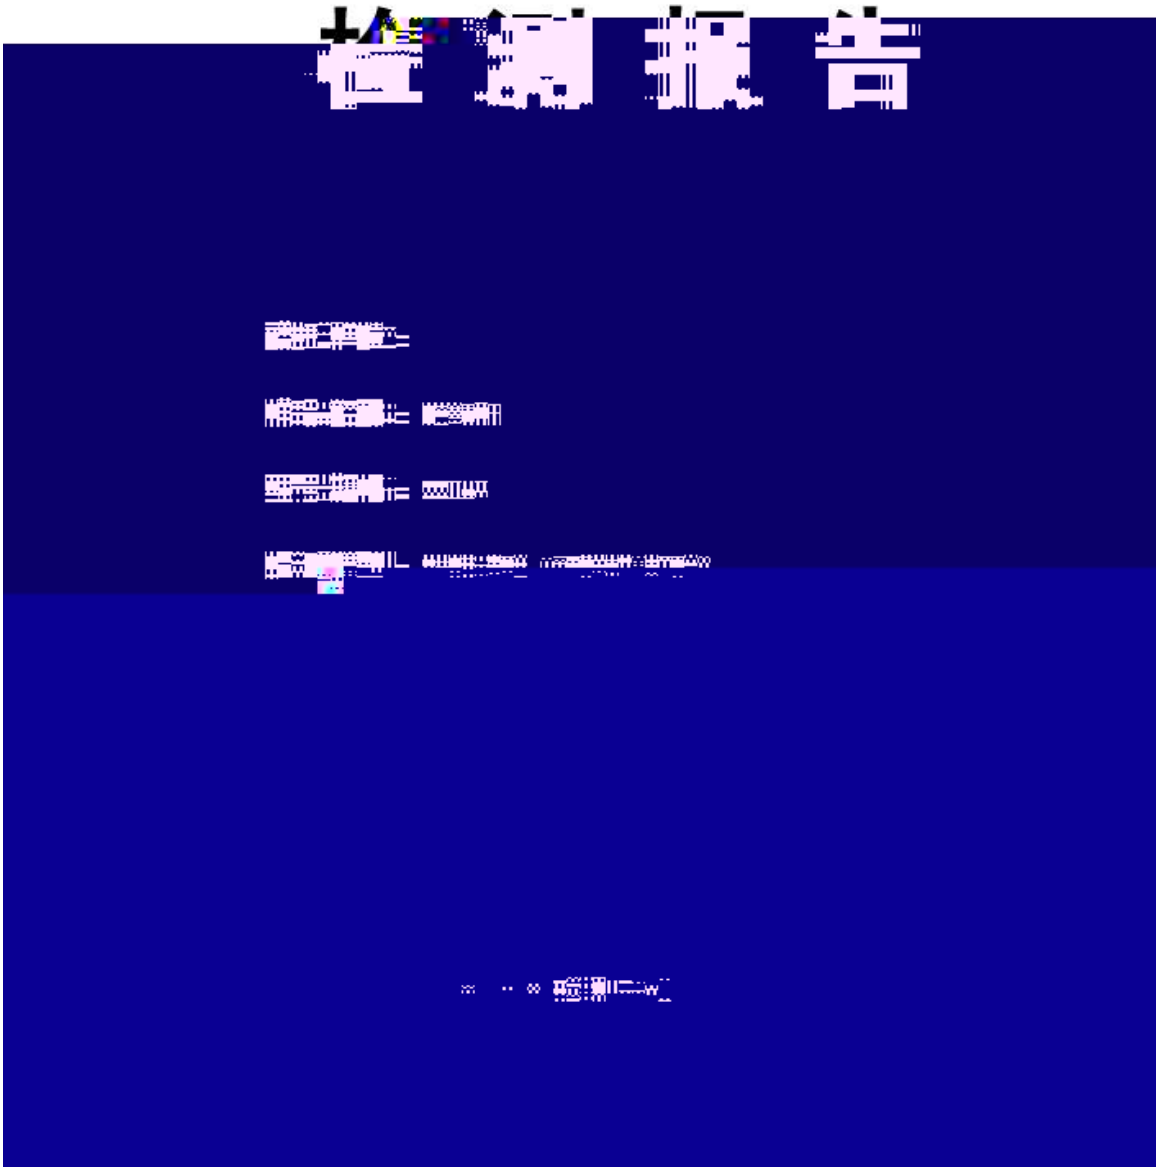

检测结果

序号	检测项目	标准要求	检测结果	评价
1	绝缘杆 工频耐压试验	试验长度：2.1m； 试验时间：1min； 试验电压：440kV		

报告正文

绝缘

1	34
2	34
3	34
4	34
5	34
6	35

“ ”

لا خه